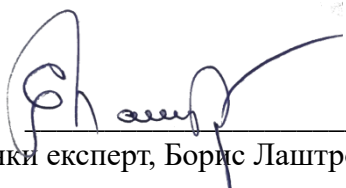



| Р. бр. | Предмет контролисања / Опсег контролисања | Врста контролисања | Референтна документа | Локација | Захтеване измене/ анализа утицаја захтеваних измена (ТОУ) | Предлог измена / образложење предложених измена (Тим за оцењивање) |
|--|---|--|---|------------------------------|---|--|
| Област контролисања – К-04. Мерни инструменти | | | | | | |
| 1. | Неаутоматске ваге: класе тачности (I) до 500 g класе тачности (II) до 40 kg класе тачности (III) и (III) до 100t | Периодично контролисање Ванредно контролисање | Правилник о неаутоматским вагама („Службени гласник РС”, бр. 29/18) SRPS EN 45501:2015 | 21410 Футог, Уроша Предића 1 | Нема измена | Предлог ОА од стране тима се не разликује од траженог ОА. |
| 2. | Аутоматске дозирне ваге класе тачности (А) и(В) до1500 kg | Прво контролисање* Периодично контролисање Ванредно контролисање | Правилник о метролошким условима за ваге са аутоматским функционисањем („Службени лист СФРЈ”, бр. 1/1984) Метролошко упутство за преглед мерила масе-вага са аутоматским функционисањем („Гласник ЗМДМ”, бр. 2/1994) *у вези са чланом 26. Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 3/18) | 21410 Футог, Уроша Предића 1 | Нема измена | Предлог ОА од стране тима се не разликује од траженог ОА |
| 3. | Ваге за грађевинске сврхе класе тачности (III) и (III) до 6000 kg | Прво контролисање Периодично контролисање Ванредно контролисање | Правилник о метролошким условима за мерила масе-ваге за грађевинске сврхе („Службени лист СФРЈ”, бр. 19/1986) QM 02.RU-02 Упутство за контролисање усаглашености вага за грађевинске сврхе са техничким и метролошким захтевима (ВАГАР, 2010.) | 21410 Футог, Уроша Предића 1 | Нема измена | Предлог ОА од стране тима се не разликује од траженог ОА |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|---------------------------------------|----------------|---|
| 4. | Тегови од 500 g до 20kg класе тачности M2 | Прво контролисање Периодично контролисање Ванредно контролисање | Правилник о метролошким условима за тегове са називним масама од 1 mg до 50 kg („Службени лист СФРЈ”, бр. 54/1988 и 6/1989) Правилник о метролошким упутствима за преглед тегова од 1 mg до 50 kg („Гласник СЗМДМ“, бр. 3/1981) | 21410 Футог, Уроша Пређића 1 | Нема измена | Предлог ОА од стране тима се не разликује од траженог ОА |
| 5. | Аутоматске дозирне ваге: класа тачности X(0,2) до 500 g; класа тачности X(0,5) до 40 kg; класа тачности X(1) и X(2) до 1500 kg | Периодично контролисање Ванредно контролисање | Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, бр. 3/2018) OIML R61-1:2004 | 21410 Футог, Уроша Пређића 1 | Нема измена | Предлог ОА од стране тима се не разликује од траженог ОА |

08.09.2023.


Технички експерт, Борис Лаштро


Вођа тима, Даниела Нинковић